

FLUKE®

CO-205

Aspirator Kit

Instruksjonsark

Innledning

Med CO-205 Aspirator Kit (Aspiratorsett) kan brukeren ta prøver av karbonmonoksidnivået (CO) i avtrekket til et fyringsanlegg i et bolighus.

Aspirator Kit fungerer som en utvidelse av Fluke CO-210 Carbon Monoxide Probe og Fluke CO-220 Carbon Monoxide Meter. Se figur 1.

⚠ Les først: Sikkerhetsinformasjon

⚠ Advarsel

Unngå personskade:

- **Plasser ikke Fluke CO-210 Carbon Monoxide Probe eller Fluke CO-220 Carbon Monoxide Meter mot et avtrekksrør.**
- **Berør ikke aspiratorsonden etter at den er fjernet fra avtrekksrøret. La sonden avkjøles for lagring.**

Kontakte Fluke

Ring følgende numre for å kontakte Fluke:

1-800-993-5853 i USA og Canada

+31-402-678-200 i Europa

+81-3-3434-0181 i Japan

+65-*276-6196 i Singapore


+1-425-350-5500 i andre land

Oppsøk Flukes websted på: **www.fluke.com**.

Bruk av aspiratoren

Slik brukes aspiratoren:

1. Fest aspiratorhetten på CO-210 eller CO-220.
2. *Nedstrøms fra fyringsanlegget, men før eventuelle sammenløp i avtrekket, lag et 5/16 tommes prøvehull i avtrekket for å stikke inn aspiratorsonden.*
3. Stikk inn ca. halvparten av aspiratorsonden inn i avtrekket.
Obs! *La ikke aspiratorsonden være i avtrekket for lenge om gangen (mer enn 1 time).*
4. Slå på CO-210 eller CO-220. (Hvis CO-210 er koblet til et måleinstrument, slå på og konfigurér måleinstrumentet.)
5. Klem aspiratorblæren 4 til 5 ganger, eller til CO-210 eller CO-220 viser en jevn avlesing.
6. Etter at prøven er tatt, tettes prøvetakingshullet med passende materiale for avtrekket.

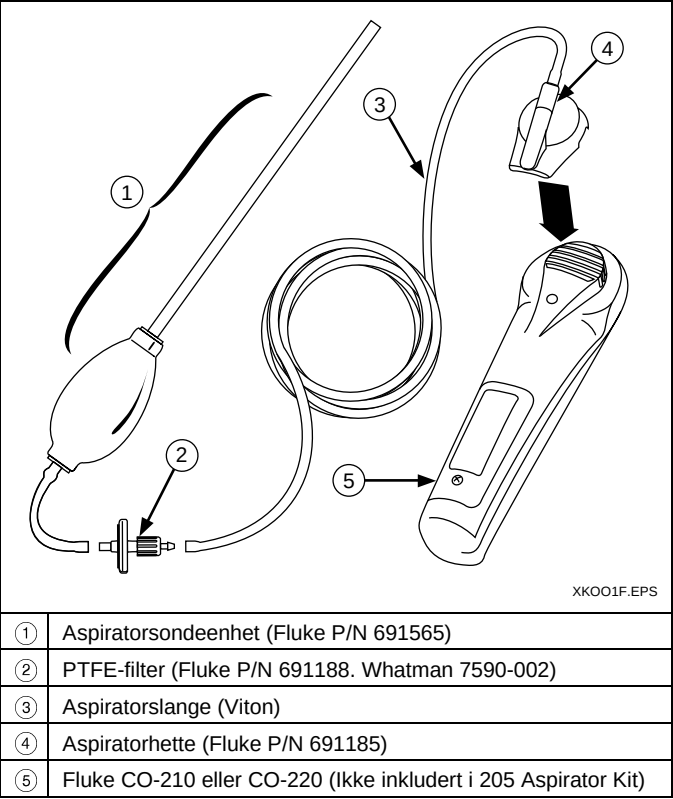

①	Aspiratorsondeenhet (Fluke P/N 691565)
②	PTFE-filter (Fluke P/N 691188. Whatman 7590-002)
③	Aspiratorslange (Viton)
④	Aspiratorhette (Fluke P/N 691185)
⑤	Fluke CO-210 eller CO-220 (Ikke inkludert i 205 Aspirator Kit)

Figur 1. CO-205 Aspirator Kit (Aspiratorsett)

Spesifikasjoner

Slangedimensjoner: Innvendig diameter Utvendig diameter Lengde	3,175 mm (1/8 tomme) 6,35 mm (1/4 tomme) 122 cm (48 tommer)
Porestørrelse på filter:	1 µm
Driftstemperatur: Sonde: Slange:	371 °C (700 °F) 204 °C (400 °F)
Lagringstemperatur:	-30 til +60 °C (-22 til +140 °F)

Skifte filteret

PTFE-filteret på aspiratorslagen kan tilstoppes ved bruk. Et tilstoppet filter reduserer nøyaktigheten til CO-avlesingen fordi luftstrømmen til måleinstrumentet blir hindret. Inspiser filteret med jevne mellomrom, og skift det hvis det er nødvendig.

Hvis det oppdages vann i slangen på *instrumentsiden av filteret*, er filteret mettet. Fjern filteret, tøm ut vannet og sett i et nytt filter.

Garanti

BEGRENSET GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING

Dette Fluke-produktet er garantert uten defekter i materiale og utførelse i ett år fra kjøpedatoen. Denne garantien dekker ikke éngangsbatterier eller skade som følge av ulykke, vanskjøtsel, misbruk eller unormale driftsforhold eller håndtering. Forhandlere har ingen fullmakt til å legge til eventuelle andre garantier som Fluke skal være ansvarlig for. For å oppnå service i garantiperioden, skal den defekte testeren sendes til nærmeste Fluke-autoriserte servicesenter sammen med en beskrivelse av problemet.

DENNE GARANTIE ER KUNDENS ENESTE OPPPREISNING. INGEN ANDRE GARANTIER, SOM GJELDER ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. FLUKE ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENSSKADER ELLER TAP SOM FØLGE AV EVENTUELL ÅRSAK ELLER TEORI. Siden noen stater eller land ikke tillater utelatelser eller begrensninger av en garanti eller av tilfeldige skader eller konsekvensskader, er det mulig at denne ansvarsbegrensningen ikke gjelder for alle kunder.

Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA. 98206-9090	Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 B.D. Eindhoven Nederland
--	--